

經濟部水利署臺北水源特定區管理局 公告

發文日期：中華民國 105 年 7 月 29 日
發文字號：水臺水字第 10504009890 號

附件：

主旨：本局網路公開徵求翡翠水庫上游污水下水道系統「石槽小區污水處理廠放流超音波流量計」採購報價案。

依據：政府採購法第 47 條第 3 項，本案屬中央機關小額採購為新台幣 10 萬元以下金額之採購案。

公告事項：

一、本案擬採購放流明渠超音波流量計組，裝設於石槽小區污水處理廠，以利流量量測及正常操作運作。

二、本維修報價費用項目包括：

(一) 超音波流量計組：1 組，並註明廠牌、型號等。


(二) 規範需求至少如下：1. 探頭測量範圍：0.2~4M，2. 準確度/解析度：0.2% F.S/1mm，3. 防護等級：主機 IP67、感測器 IP68，4. 可顯示水位高度、瞬間流量、累積流量及故障警示等訊息，5. LCD 螢幕顯示、背光螢幕，6. 電源：110 或 220VAC，7. 工作溫度：-40~70 度 C。

(三) 現場安裝及測試。

三、本案投標（報價）廠商資格營業項目需與該業相關，如：CE01010 一般儀器製造業、CB01030 污染防治設備製造業、E604010 機械安裝業、EZ05010 儀器、儀表安裝工程業、F113100 污染防治設備批發業、F113030 精密儀器批發業、F213100 污染防治設備零售業、F213040 精密儀器零售業等。廠商投標（報價）時，除報價單外，請一併提送廠商營業項目供審查。

四、本案採責任施工，投標（報價）前廠商應親赴現場勘查原有系統，徹底瞭解設備現況，再行投標（報價），如換新之零件不與本系統之原規格相容，依違約處理。

五、本案保固 3 年，採最低價得標。廠商應做好施工

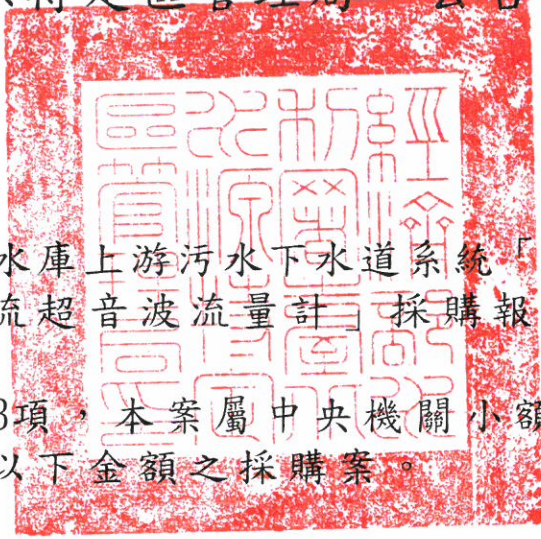

裝

訂

線



相關安全措施並應自行投保雇主意外責任險。
發生施工意外如歸屬於廠商責任時，由廠商自行負責處理及解決，與本局無關。

- 六、本案承辦人：魏俊生，聯絡電話：02-29173282
分機346。報價單請用傳真FAX：02-29117280或
電子信箱a620070@ wratb.gov.tw或親送或掛號郵
寄至本局水質課，截止期間為105年8月5日17：
30分止。施工時應拍攝照片（前、中、後），
完工期限為得標後經本局以函或電話或電子郵件
通知後30日內完成現場安裝及整體測試。
- 七、如發生違約情形時，依「政府採購法」規定辦理。

局長周文祥

